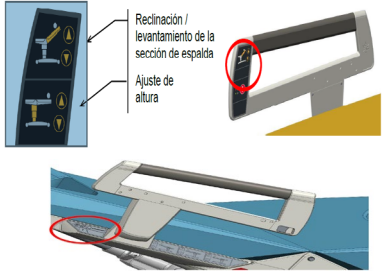
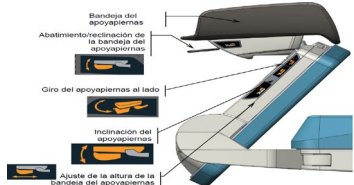


ANEXO N° 2
PROPUESTA TÉCNICA

PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE 03 CAMAS DE PARTO INTEGRAL NHA”

1	CARACTERÍSTICAS GENERALES:03 CAMAS DE PARTO INTEGRAL	REQUERIMIENTO	Cumple SI/NO	Pag. Documento de respaldo	Observación
1.1	Incluye Cama clínica eléctrica para uso en parto integral nueva, sin uso, ni refaccionada	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Cama para parto integral, nueva, sin uso, no es refaccionada ni acondicionada.
1.2	Estructura de acero inoxidable o metálica con terminaciones en pintura epóxica	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama de parto cuenta con estructura de acero con revestimiento de pintura en polvo, con terminación epóxica.
1.3	Plataforma dividida en al menos 3 secciones (respaldo, asiento, y apoya pies)	OBLIGATORIO	SI	Pág. 16 Manual de Usuario AVE 2	Cama de parto cuenta con plataforma dividida en 3 secciones: espalda, asiento, piernas.
1.4	Ajuste de profundidad del asiento entre 20 o 30 cm o superior.	10	NO		
1.5	División entre asiento y piecera en forma de V u ovalada.	10	SI	Pág.1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Cama de parto cuenta con división ovalada (en U) entre asiento y piecera. 
1.6	Cuenta con respaldo de cabeza y pies desmontable, desinfectable y lavable	OBLIGATORIO	SI	Pág. 65 Manual de Usuario AVE 2 Pág.1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Cama cuenta con secciones de cabecera, asiento y piecera desmontables, lavables y desinfectables. 

1.7	Cuenta con bandeja deslizante para líquidos	OBLIGATORIO	SI	Pág. 18 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama de parto cuenta con bandeja deslizante para líquidos. 
1.8	Cuenta con control eléctrico para el manejo de la cama Integrado en al menos baranda o laterales del lecho, en cara interna para el paciente y en externa para personal clínico	OBLIGATORIO	SI	Pág. 29 y 31 Manual de Usuario AVE 2	Barandas cuentan con controles para paciente en ambas barandas en su cara interna y para manejo de la cama por parte del personal clínico cuenta con controles en ambos laterales del lecho. <u>3.1.1 Descripción del control interno para el paciente (integrado en ambas barandas)</u> 
1.9	Cuenta con control manual para el manejo de la cama	20	SI	Pág. 33, 36 a 48 Manual de Usuario AVE 2	Cama cuenta con control manual para manejo, principalmente en ajuste de sección de pies, de piernas y respaldo por medio de manejo de RCP.
1.10	Apoya pies desmontable o retráctil	OBLIGATORIO	SI	Pág. 15 y 19 Catálogo AVE 2 - LINET Pág. 35 Manual de Usuario AVE 2	La sección de la piédera es retráctil bajo la cama, por lo que no es necesario extraerlo de la cama ofertada. Recomendamos observar la página 15 del documento de respaldo en el cual se aprecia que la sección es reclinable bajo la cama.
1.11	Cuenta con piernas tipo Goepel ajustables diferentes alturas	OBLIGATORIO	SI	Pág. 8 Catálogo AVE 2 - LINET Pág. 40 Manual de Usuario AVE 2	Soportes de piernas, tipo Goepel, abatibles, ajustables en altura y no extraíbles. 

1.12	Cuenta con asas de parto ergonómicas abatibles	OBLIGATORIO	SI	Pág. 52 Manual de Usuario AVE 2	Cama cuenta con asas de parto ergonómicas y abatibles. 
1.13	Barra acolchada para ayuda en labor de parto (En forma de arco)	OBLIGATORIO	SI	Pág. 18 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama ofertada cuenta con barra acolchada para ayuda con labores de parto, esta tiene forma de arco. 
1.14	Cuenta con soporte para barra portasueros	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama de parto cuenta con dos receptáculos para porta sueros hacia la cabecera de la cama.
1.15	Cuenta con 04 ruedas antiestáticas, de 15 cm de diametro o mayor con sistema de frenado centralizado	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama cuenta con cuatro ruedas de 15 cm de diametro, antiestáticas, con sistema de frenado centralizado.
1.16	Capacidad de carga al menos 220 kg (carga máxima de seguridad)	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama cuenta con capacidad de carga de paciente de 240 kg.
1.17	Capacidad de carga al menos 240 kg (carga máxima de seguridad)	10	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama cuenta con capacidad de carga de paciente de 240 kg.
1.18	Capacidad de carga en la seccion de los pies mayor o igual a 150 kg	40	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Capacidad de carga de sección de apoya pies de 150 kg.
1.19	Permite distintas posiciones para la realización del parto al menos parto vertical y parto en cuatro apoyos (adjuntar imágenes)	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 AVE 2 Poster Posiciones	Cama de parto ofertada permite diferentes posiciones para la realización de parto vertical y en cuatro posiciones.
1.20	Cuenta con rango de inclinación del respaldo de 0° a 62° o rango superior	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Rango de segmento de respaldo de -10° a 70°, rango superior al solicitado.
1.21	Angulación de elevación del asiento igual o superior a 15°	30	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Rango de elevación del asiento es de hasta 18,5°.
1.22	Cuenta con posición trendelenburg de $\pm 8^\circ$ o rango mejor	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama cuenta con trendelenburg es de 10°.
1.23	Cuenta con posición trendelenburg de $\pm 10^\circ$ o rango mejor	10	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama cuenta con trendelenburg es de 10°.
1.23	Cuenta con posición trendelenburg de $\pm 12^\circ$ o rango mejor	10	NO		

1.24	Cuenta con sistema o botón de accionamiento rápido para RCP.	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET Pág. 33 Manual de Usuario AVE 2	Cama cuenta con sistema de accionamiento rapido manual para RCP. 
1.25	Fuente de alimentacion 220V +-10% 50/60 HZ, con enchufe nacional.	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Alimentación de 230 V 50/60hz, con enchufe tipo L nacional.
2	COLCHÓN				
2.1	De alta densidad	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Cama de parto cuenta con colchón de espuma de alta densidad.
2.2	Espesor mínimo de 8 cm en pies y cabeza	OBLIGATORIO	SI	Pág. 19 Catálogo AVE 2 - LINET	Sección de respaldo es de 13 cm de grosor mientras que la sección de la piecera es de 10 cm.
2.3	Con funda o tapiz protector de material impermeable y superficie antideslizante, resistente a limpieza y desinfección clínica	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Cama de parto ofertada cuenta con funda sin costuras con un compuesto bacteriostático, con propiedades ignifugas, impermeable lavable y desinfectable con amonio cuaternario y otros agentes hospitalarios utilizados para desinfectar o descontaminar.
2.4	Ignífugo	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 Carta Respaldo Cama de Parto Ave 2	Cama de parto ofertada cuenta con funda sin costuras con un compuesto bacteriostático, con propiedades ignifugas, impermeable lavable y desinfectable con amonio cuaternario y otros agentes hospitalarios utilizados para desinfectar o descontaminar.
3	ACCESORIOS POR CAMA				
3.1	01 Recipiente para fluidos de acero inoxidable, polímero, equivalentes técnicos o calidad superior de 8 lts de capacidad o mayor	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Oferta incluye 01 recipiente de 10 litros de acero inoxidable de calidad superior al solicitado.
3.2	01 Porta sueros en forma de 4 ganchos.	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Oferta incluye porta suero de 4 ganchos.
3.3	01 soporte para oxígeno	20	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Oferta incluye soporte de oxígeno.
3.4	01 almohada lumbar	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Oferta incluye almohada lumbar ajustable en altura.

3.5	Apoya pies regulables y lavables	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Cama cuenta con apoya pies tractil, lavanle y regulable.
3.6	Incluye funda de cambio o al menos 20 kits de fundas desechables por cama.	20	SI	Pág.1 CERT ACCESORIOS CAMA PARTO	Oferta incluye los 20 kits de fundas desechables.
4	NORMATIVAS				
4.1	Normas: CE, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE y/o FDA. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 Declaration of Conformity AVE 2 CE	Se adjunta certificado Declaración de conformidad CE.
4.2	IEC 60601 y/o 13485 u homóloga. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 Certificado TUV AVE 2_EN IEC 60601-2-52 + IPX4 Pág.1 ISO 13485_LINET	Se adjunta certificado de normativa IEC 60601 y de norma ISO 13485.
4.3	ISO 9001. En catálogo, ficha técnica o certificado adicional que lo acredite	OBLIGATORIO	SI	Pág.1 ISO 9001_LINET	Se adjunta certificado ISO 9001.
5	CAPACITACIONES				
5.1	Adjunta certificado de fábrica de especialista que realizará la capacitación.	20	SI	Pág. 1 Certificado Especialistas Linet_DH	Se adjunta certificado solicitado
5.2	Debe incluir capacitación a personal clínico y técnico. Estas capacitacioness deberán ser desarrolladas por un especialista/aplicacionista y su ejecución determinará la recepción conforme de los equipos.	OBLIGATORIO	SI	Pág. 2 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se incluye todo lo solicitado en materia de capacitaciones al personal clínico y técnico.
6	POSTVENTA				
6.1	Debe incluir al menos 01 mantención preventiva anual durante el período de garantía. Si oferta mayor cantidad de mantenciones a las solicitadas favor describirlo en la columna "Comentario Proveedor"	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se incluye lo solicitado, un mantenimiento preventivo anual durante todo el periodo de garantía
6.2	Garantía por al menos 12 meses	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se ofertan 36 meses de garantía
6.3	Manual técnico: identificación de aspectos técnicos para su operatividad (calibración, rendimientos, etc.) Uno en idioma original y uno en idioma español o inglés. Para ambos casos debe entregar una copia en digital. (Será solicitado al adjudicatario).	OBLIGATORIO	SI	Pág. 3 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se incluye todo lo solicitado en materia de entrega de manual tecnico y de usuario

6.4	Manual de usuario: identifica aspectos de operación para uso. En idioma español. En formato digital. (Será solicitado al adjudicatario).	OBLIGATORIO	SI	Pág. 3 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se incluye todo lo solicitado en materia de entrega de manual tecnico y de usuario
6.5	Debe incluir instalación y puesta en marcha para todos los equipos ofertados	OBLIGATORIO	SI	Pág. 1 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se incluye todo lo solicitado
6.6	Garantía de suministro de insumos y/o repuestos del equipo que avale el correcto y normal funcionamiento de éste durante su periodo de garantía. (Adjuntar carta de compromiso).	OBLIGATORIO	SI	Pág. 3 CERT DESCRIPCIÓN OFERTA	Se adjunta carta compromiso de disponibilidad de repuestos

Puntaje a evaluar máximo	200
Puntaje obtenido	